



Sokółka dn. 13.10.2020r

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 214000 euro na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz.U.2017r. poz.500).

Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2020 Nr ogłoszenia – 2020/S 194-468646 z dnia 06 - 10- 2020r

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ:

1. Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 8 oraz dodatek nr 5 – grupa 1 – pkt. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by dostarczenie urządzenia zastępczego następowało w przypadku gdy naprawa w okresie gwarancyjnym wynosi powyżej 5 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500,00zł do 200,00zł ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy zapisów umowy § 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dotyczy dodatku nr 5 – grupa 1 – pkt. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas reakcji serwisu wynosił 72 h w okresie gwarancyjnym ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. GRUPA – 5 poz. 1 Defibrylator z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 - 1 – kpl Poz.37,38 Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanych w tych pozycjach wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. GRUPA – 6 poz. 1. Wózek transportowy w pozycji leżącej z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 7kpl. Poz.7 Czy Zamawiający dopuści: Długość całkowita wózka 2184 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. GRUPA – 6 poz. 1. Wózek transportowy w pozycji leżącej z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 – 7kpl. Poz.20 Czy Zamawiający dopuści: Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 58-86 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. § 6. PUNKT 3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie na wezwanie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbek asortymentu w przypadku gdy Producent nie będzie miał na stanie w magazynie a w zamian wytwórca przedstawi jednoznaczne oświadczenie że oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. DODATEK Nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy SPZOZ APMED 3 / 2020 Czy Zamawiający w zakresie grupy 15 wyrazi zgodę na złożenie oferty na poszczególne pozycje, podzielenie tego zadania pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności i przystąpienie mikro przedsiębiorstw.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 64 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cłoward blaszka rozszerz. ostry 40x15mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cłoward blaszka rozszerz. tępa 40x15mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 66 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cłoward blaszka rozszerz. ostry 50x15mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cłoward blaszka rozszerz. tępa 50x15mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 68 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cłoward blaszka rozszerz. ostry 60x15mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

18. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 69 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cłoward blaszka rozszerz. tępa 60x15mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

19. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 40 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dźwign.kostna schumacher szer.35mm 280mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 44 POZ. 10 lp. 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dźwignia kostna szer.35mm 290mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. GRUPA 15 POZ. 10 lp. 84 POZ. 11 lp. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie haczyk do nerwów dł. 180 mm 6 1/2" odgięty w 3/4 koła zakończenie ostre średnica koła 4 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie haczyk powiek.desmarres 12x16mm 130mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie haczyk siodełkowy typ desmarres, 8mm szerdł13cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 120x50 długość 260 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak brzuszny typ balfour z regulowanym położeniem łyżki środkowej wysokość 200 mm szerokość 170 mm rozwarcie 155 mm łyżka środkowa wymiary 45x80 mm łyżki boczne 60 mm głębokość ,łyżki boczne o branzach perforowanych prawa stała lewa ruchoma

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ caspar 55x14 mm długość 210 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

27. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ caspar 55x14 mm długość 210 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

28. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 37 POZ. 2 lp. 14 POZ. 11 lp. 85 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm i 27x16mm oraz 26x16mm i 30x16 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. GRUPA 15 POZ. 10 lp. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Hak operacyjny typ fritsch 35x40 mm figura 2 długość 235 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

30. GRUPA 15 POZ.6 lp. 57 POZ. 10 lp. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ israel pięcioletny tępy 45x50 mm lub czteroletny wym. 40x40mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

31. GRUPA 15 POZ. 5 lp. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ kocher jednozębny ostry długość 220 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

32. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 63Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ langenbeck 33x14 mm przekrój owalny długość 220 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

33. GRUPA 15 POZ. 7 lp. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ langenbeck 40x10 mm przekrój owalny długość 220 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34. GRUPA 15 POZ.6 lp. 60 POZ. 8 lp. 39 POZ. 9 lp. 27 POZ. 10 lp. 81 POZ. 11 lp. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ volkmann czteroletny półostrzy 9x19 mm długość 220 mm+/-5mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

35. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ volkmann sześćioletny półostrzy 9x29 mm długość 220 mm+/-5mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

36. GRUPA 15 GRUPA 15 POZ. 6 lp. 46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszcze do trzymania kości typ lane dł 330 mm z zapadką szerokość szczeki 13 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

37. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszcze kostne typ semb dł. 195 mm szczęki ząbkowane szerokość 8 mm ramiona z zapadką i jedną sprężynką.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszcze kostne typ semb dł. 195 mm szczęki ząbkowane szerokość 8 mm ramiona z zapadką i jedną sprężynką.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

39. GRUPA 15 POZ. 2 lp. 23 POZ. 4 lp. 67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosz stalowy z perforacją w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami, wymiary 405x255x65mm +/- 5mm wyposażony w regulowane ręczki w min. 3 pozycjach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 23 POZ. 5 lp. 25 POZ. 7 lp. 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżeczka kostna dwustronna typ jakobson dł. 140 mm główki owalne szerokość 4,0 mm i 4,6 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

41. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżeczka kostna dwustronna typ williger dł. 130 mm główki owalne szerokość 2 mm i 3 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

42. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 71 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżka środkowa wymiary 45x80 mm do haka brzuszego typ Balfour

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

43. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 36 POZ. 11 lp. 42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młot. bergmann 300gr.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

44. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 37 POZ. 8 lp. 33 POZ. 9 lp. 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młotek typ ombredanne waga 560 g, dł. 250 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

45. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 55 POZ. 5 lp. 40 POZ. 7 lp. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młotek typu cottle, 350g,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

46. GRUPA 15 POZ. 10 lp. 115 POZ. 11 lp. 52 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,45 litra wymiary 12,8x wys.55mm,

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

47. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki preparacyjne odgięte typ nelson metzenbaum długość 250 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

48. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 17 POZ. 2 lp. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczki preparacyjne typ mayo- stille odgięte długość 150 mm ostrza tępo tępe

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 52 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obgryzacz kostny typ luer – stille dł. 220 mm szczęki odgięte z przekładnią szerokość 9 mm długość 17 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

50. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pinceta anatomiczna prosta izolowana długość 210 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

51. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 3 POZ. 2 lp. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szerokość pyszczka 2,8mm prosta dł.160mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

52. GRUPA 15 POZ. 7 lp. 8 POZ. 10 lp. 71 POZ. 11 lp. 13 POZ. 10 lp. 72 POZ. 11 lp. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szerokość pyszczka 2,8mm prosta dł.160mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

53. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 6 POZ. 2 lp. 9 POZ. 5 lp. 11 POZ. 6 lp. 17 POZ. 7 lp. 9 POZ. 8 lp. 13 POZ. 9 lp. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 210 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

54. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 38 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pobijak dł. 200 mm główka średnicy 120mm z nacięciami krzyżowymi podziałka 0,5 mm rękojeść z tworzywa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

55. GRUPA 15 POZ. 5 lp. 68 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podważka kostna typ hohmann szerokość łyżki 10 mm dł. 220 mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

56. GRUPA 15 Pytanie - Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga pokrywa do wanny kontenera wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrywy wraz z kontenerem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pokrywa srebrna o wymiarach 465x281x36 do wanny kontenera wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej wraz z kontenerem.

57. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 60 POZ. 11 lp. 50 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pudełko wewnętrzne na igły wymiary 65x13 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

58. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie retractor love do korzonków nerwowych prosty 200mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

59. GRUPA 15 POZ. 7 lp. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanna do kontenera o wymiarach 285x280x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

60. GRUPA 15 POZ. 2 lp. 25 POZ. 3 lp. 24 POZ. 4 lp. 68 POZ. 5 lp. 60 POZ. 11 lp. 89 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanna do kontenera o wymiarach 465x280x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

61. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 55 POZ. 1 lp. 45 POZ. 6 lp. 87 POZ. 9 lp. 42 POZ. 10 lp. 51 POZ. 10 lp. 117 POZ. 11 lp. 57 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanna do kontenera o wymiarach 580x280x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

62. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłębnik rowkowy typ payer prosty szerokość 8 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

63. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki preparacyjne typ overholt-geissendoerfer odgięte długość 210mm figura 2

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

64. GRUPA 15 POZ. 5 lp. 58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uchwyt t dł.160 z opr.trójsz.do śr.6,5mm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

65. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta o wymiarach: 280 x 220 x 220 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

66. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta o zasilaniu: Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, 8A.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

67. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z grzałką PTC o mocy 1000W?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

68. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z kołderkami grzewczymi o konstrukcji minimalizującej prądy powietrzne, bez zintegrowanego systemu filtracji?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

69. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z 2 filtrami w urządzeniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

70. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z koszykiem na podstawie jezdnej umożliwiającym odłożenie przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

71. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta o 4 zakresach temperatury: 32,38,43 +/-1.5% i temp otoczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

72. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z podwójnym systemem zabezpieczeń: pierwsze 46 +/-3 st. C na końcu węża, drugie wyższa niż 56 st. C na wyjściu z urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

73. GRUPA – 19 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. Nr 2 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74. Grupa nr 2 pkt. 18 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z systemem indywidualnej blokady kół zamiast wymaganego centralnego systemu blokowania kół aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

75. Dotyczy grupa 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści optykę histeroskopową o długości 300 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

76. Dotyczy grupa 14, poz. 10: czy Zamawiający dopuści pojemni sterylizacyjny – wanna o wymiarach zewnętrznych 475x272x100 mm, pokrywa pojemnika z bezobsługowym filtrem typu Bio-Barrier? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

77. Dotyczy grupa 14, poz. 11: czy Zamawiający dopuści kosz druciany o wymiarach 405x245x50 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

78. Dotyczy grupa 14, poz. 12: czy Zamawiający dopuści silikonową matę niebieską o wymiarach 440x250? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

79. GRUPA – 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Oferowany parametr jest korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

80. GRUPA – 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o podstawie jezdnej o wymiarach 938mm x 568 mm oraz wcięciu od stron bocznych o głębokości 80mm, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga? Oferowane parametry z uwagi na mniejsze gabaryty podstawy są korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

81. GRUPA – 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o pozycji maksymalnej 1240mm? Oferowany parametr jest korzystniejszy dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

82. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

83. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach użytkowych szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 500x484x93 mm, (przy wysokości frontu 1x234mm): 500x484x173 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

84. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z szufladami wyposażonymi w wyjmowane podziałki z plexi, dzielące szufladę na 8 części (możliwość regulacji wielkości części)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

85. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat wyposażony jest w bandy o wysokości 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

86. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt typu C, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

87. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

88. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 2 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, których sposób wykonania nie wymaga użycia łącznika z tworzywa celem połączenia z korpusem wózka? Szyna wózka nie jest zintegrowana z korpusem tj. nie tworzy jednolitej całości, ale jest na trwałe przymocowana do korpusu. Poniżej oferowane rozwiązanie.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

89. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym stelaż nadstawki wykonany jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (3040, bez kanałów montażowych umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej? Doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria nie wymaga przeróbek technologicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

90. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego w formie kosza kolanowego wykonanego z tworzywa, montowanego na stałe do ściany bocznej wózka, z pokrywą otwieraną góra/dół (nie wahadłową)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

91. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w koszyk na akcesoria o wymiarach: 311x226x255mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

92. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na rękawiczki o wymiarach: 138x106x251mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

93. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do przetaczania wykonany z rurki fi 20mm, ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

94. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria montowane są w odmienny, ale równie funkcjonalny sposób, tj. za pomocą specjalnych uchwytów ze stali nierdzewnej indywidualnie dobieranych w zależności od rodzaju akcesorium?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

95. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

96. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach użytkowych szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 500x484x93 mm, (przy wysokości frontu 1x234mm): 500x484x173 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

97. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z szufladami wyposażonymi w wyjmowane podziałki z plexi, dzielące szufladę na 8 części (możliwość regulacji wielkości części)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

98. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat wyposażony jest w bandy o wysokości 60mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

99. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat boczny o wymiarach 474x500mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

100. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w korpus wykonany z pojedynczej blachy, z frontem wykonanym z podwójnej blachy z wypełnieniem materiałem wygłuszającym, minimalizującym wibracje, absorbującym drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości – w postaci „plastra miodu”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

101. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt typu C, wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


102. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

103. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat ze stali nierdzewnej lub z ABS, ale bez możliwości zdjęcia celem wymiany?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 lub z ABS.

104. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 odcinki szyny instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, których sposób wykonania nie wymaga użycia łącznika z tworzywa celem połączenia z korpusem wózka? Szyna wózka nie jest zintegrowana z korpusem tj. nie tworzy jednolitej całości, ale jest na trwałe przymocowana do korpusu. Poniżej oferowane rozwiązanie.

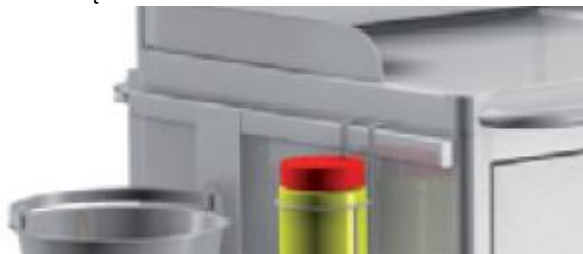

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

105. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym stelaż nadstawki wykonany jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (3040, bez kanałów montażowych umożliwiającym zmianę regulacji wysokości szyny instrumentalnej? Dopuszczenie wózka w dodatkowe akcesoria nie wymaga przeróbek technologicznych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego w formie kosza kolanowego wykonanego z tworzywa, montowanego na stałe do ściany bocznej wózka, z pokrywą otwieraną góra/dół (nie wahadłową)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

107. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w koszyk na akcesoria o wymiarach: 311x226x255mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

108. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na rękawiczki o wymiarach: 138x106x251mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

109. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 1x miskę na odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności 3 litry?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

110. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do przetaczania wykonany z rurki fi 20mm, ze stali nierdzewnej niemalowanej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

111. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria montowane są w odmienny, ale równie funkcjonalny sposób, tj za pomocą specjalnych uchwytów ze stali nierdzewnej indywidualnie dobieranych w zależności od rodzaju akcesorium?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

112. GRUPA – 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w stelaż wykonany z profili zamkniętych o przekroju 30x30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. GRUPA – 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości całkowitej 1615mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

114. GRUPA – 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o głębokości 720mm, przy założeniu że stół ma posiadać odbojniki ochronne nad kołami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. GRUPA – 11 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w stelaż wykonany z profili zamkniętych o przekroju 30x30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. GRUPA – 11 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości całkowitej 1165mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

117. GRUPA – 11 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o głębokości 670mm, przy założeniu że stół ma posiadać odbojniki ochronne nad kołami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

118. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w jeden uchwyt do prowadzenia? Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to prosimy o dopuszczenie stolika o długości całkowitej (długość podana z uchwytami) – 975mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w jeden uchwyt.

119. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w blat dolny o wymiarach 364x743mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

120. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wysokości 850mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

121. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika, w którym uchwyt wykonany jest z rurki fi 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

122. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w wysokiej jakości układ jezdny złożony z kółek w obudowie z tworzywa sztucznego, kółka fi 80mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

123. Załącznik nr.5, grupa 9, punkty 1-18, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego wideolaryngoskopu:

Lp	Wymagane parametry medyczno-techniczne	Parametr wymagany TAK/NIE	Parametr oferowany	Punktacja	Przyznane pkt. (wypełnia Zamawiający)
1.	Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 "	TAK, podać	Rękojeść wideolaryngoskopu z torem wizyjnym, bezprzewodowa ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 2,4".		
2.	Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni	TAK, podać	Brak możliwości obracania wyświetlacza. Wyświetlacz umieszczony w stałej pozycji.		
3.	Kamera CMOS	TAK	Wyposażony w kamerę CMOS		
4.	Źródło światła: LED	TAK	Posiada źródło światła LED		
5.	Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii	TAK / NIE	Wideolaryngoskop wyposażony we wskaźnik pozostałego czasu działania baterii	TAK – 2pkt NIE – 0pkt	
6.	Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min.	TAK	Zasilany trzema bateriami AAA, w zestawie z 4 kompletami baterii pozwalającymi na ponad 320 min ciągłej pracy urządzenia	250 minut – 0 pkt Powyżej 250 minut - 2 pkt	

7.	Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii	TAK	Urządzenie posiada wskaźnik konieczności wymiany baterii		
8.	Waga urządzenia nie większa niż 250g	TAK, podać	Waga urządzenia z łyżką około 230g		
9.	Ochrona przed wnikaniem wody min IPx7	TAK, podać	Brak możliwości maczania urządzenia. Dezynfekcja za pomocą wycierania husteczkami nasączonymi alkoholem.		
10.	Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2,3,4	TAK, podać	Łyżki dostępne w rozmiarach 1,2,3		
11.	Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3	TAK, podać	Łyżki w rozmiarze 3 z kanałem roboczym lub bez, do wyboru Zamawiającego. Łyżki posiadające kanał prowadzący rurkę intubacyjną są przeznaczone do trudnych i bardzo trudnych intubacji, znacząco ułatwiają intubację oraz skracają czas jej trwania		
12.	Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze	TAK	TAK, Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii aparatu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym max 72h w dni robocze		
13.	W przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedzibą zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności	TAK	TAK, w przypadku naprawy powyżej 3 dni poza siedzibą zamawiającego zapewnić urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności		
14.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia min. jedno	TAK	TAK, Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia		
15.	Urządzenie fabrycznie nowe gotowe do użycia	TAK	TAK, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, wyprodukowane w USA		
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	TAK	TAK		
17.	Serwisant adres, kontakt	TAK, podać	Biameditek, Elewatorska 58, 15-620 Białystok		
18.	Gwarancja min. 24 miesiące z bezpłatnymi przeglądami w okresie gwarancyjnym łącznie z wpisem do paszportu i bezpłatną wymianą części przewidzianą przez producenta	TAK, podać	36 miesięcy gwarancji	24 m-ce – 0pkt Powyżej 24m-cy – 1pkt z każdy miesiąc dodatkowo	
Suma przyznanych pkt:					

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

124. Dotyczy: _Kolumna artroskopowa z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 - 1 – kpl Źródło światła LED Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED z funkcją ICG (obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej- obrazowania w bliskiej podczerwieni) oraz możliwością podświetlenia moczowodów za pomocą wrzecion światłowodowych wprowadzanych do cewników do szynowania moczowodów o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Źródło światła LED-1szt.
1	Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących trybów: - Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)), - Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz - Transiluminacja w bliskiej podczerwieni .
2	Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocjaninowej ICG

3	Urządzenie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm
4	Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD
5	Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta
6	Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.
7	Tryb gotowości standby
8	Menu urządzenia w języku polskim
9	Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła światła
10	Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów
11	Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie moczowodów
12	Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery
13	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
14	Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014,
15	Urządzenie laserowe klasy 1M
16	Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera
17	Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm
18	Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm dł.
19	Waga 7,3 kg

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

125. Sterownik kamery 4K Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika kamery, głowicy i obiektywu 4K z funkcją obrazowania w bliskiej podczerwieni o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Endoskopowa kamera 4K -1szt.
1	Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie)
2	Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli)
3	Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy
4	Rozdzielczość kamery 4K UHD
5	System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz
6	Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa
7	Wbudowane programy specjalistyczne 9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, histeroskopia, laparoscopia, laser, mikroskop, standard
8	Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED
9	Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne)
10	Wyświetlanie obrazu w trybie światła białego z fluoryzującym środkiem ICGoznaczonym kolorem zielonym
11	System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia współpraca ze źródłem światła LED
12	Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności wiązki światła
13	Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160))
14	Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0 – 2szt.
15	Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów dodatkowych
16	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia.
17	Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery
18	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej
19	Waga głowica kamery - 0,5 kg
20	Waga konsoli kamery - 5,44 kg
21	Przewód głowicy kamery - długość 3,05m

22 | Wymiary konsoli kamery: 33,02 cm szer.x11,32 cm wys. X 42,23 cm głęb.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

126. Archiwizator medyczny Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cyfrowego rejestratora medycznego o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi-1szt.
1	uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
2	wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)
3	Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku
4	Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
5	personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji
6	możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
7	współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3
8	lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika
9	zapis dźwięku i komentarzy głosowych
10	Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu
11	Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota
12	Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
13	Obraz: rozdzielczość: NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 × 1024,High Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
14	Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników
15	Wejścia wideo: 2xS-Video, 1x sygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080
16	Wyjścia wideo: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I)
17	Dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł
18	Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
19	Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć
20	Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu
21	Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość)
22	Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie
23	Moduł obsługi DICOM
24	Pilot zdalnego sterowania urządzeniami
25	Możliwość głosowego sterowania urządzeniami
26	Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny)
27	Możliwość zapisania 500 przypadków
28	Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
29	Obsługa Wifi
30	Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM
31	Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego
32	Masa całkowita: 10,2kg
33	31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

127. Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cyfrowego rejestratora medycznego bez tabletu sterującego, jako rozwiązanie równoważne? Cyfrowy rejestrator medyczny posiada więcej funkcji, między innymi lista bezpieczeństwa chirurgicznego oraz profile użytkowników wraz z przypisaniem ustawień urządzeń. Dodatkowo wbudowany dysk twardy z pojemnością 1 TB z automatycznym zapisem w archiwum bez konieczności używania dodatkowego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

128. Głowica kamery 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania głowicy kamery z 4 przyciskami dającymi możliwość przypisania 8 funkcji jednoczesnego sterowania, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

129. Monitor medyczny 4K Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora medycznego 4K 32" o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Medyczny monitor 4K 32"-1szt.
1	Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160
2	Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD
3	Przekątna ekranu min. 32", ekran panoramiczny
4	Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm
5	Jasność: 525 cd/m ² standard
6	Kontrast: 1500:1 standard
7	Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 specjalności
8	Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu - minimum 4 efekty.
9	Dwustronna powłoka antyrefleksyjna
10	Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H
11	Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora
12	Sterowanie monitorem poprzez pokrętkę i 4 przyciski na panelu przednim
13	Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0
14	Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 60Hz
15	Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10-bit)
16	Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski
17	Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video
18	Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame)
19	Zużycie energii: 85W
20	Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość x wysokość x głębokość)
21	Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm
22	Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A
23	Waga netto monitora: 10,5 kg

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

130. Monitor medyczny 4K 32" Czy Zamawiający wymaga aby monitor posiadał osłonę matrycy, celem ochrony przed przypadkowym uszkodzeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby monitor posiadał osłonę matrycy.

131. Konsola do obsługi shavera Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednej konsoli do shavera i waporyzacji o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Konsola shavera i wpaoryzacji-1 szt
1	Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz
2	Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy
3	Funkcja modulacji siły cięcia
4	Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) - 120W, 3 poziomy mocy
5	
6	Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm
7	Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem
8	Elektrody jednoczęściowe
9	Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę
10	
11	Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm)
12	Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°)
13	System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyki artroskopowych przez działającą elektrodę

14	Możliwość podłączenia shavera artroskopowego
15	Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw
16	Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID)
17	Możliwość pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym
18	Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia
19	Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego
20	Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika
21	Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

132. Rękojeść shavera Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu shavera o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

1	Uchwyt shavera 4 szt
2	Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę.
3	Zakres obrotów do 12000 obr/min
4	Oscylacje do 3000 ocykli/min
5	Programowalne przyciski sterujące na uchwycie
6	Mocowanie ostrzy w systemie zatraskowym
7	Zakres regulacji siły ssania 0-100%
8	Obrotowy króciec kanału ssania
9	Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania
10	Wyposażony w silnik bezszczotkowy
11	Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem
12	Możliwość sterylizacji w autoklawie

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

133. Pompa Artroskopowa Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pompy artroskopowej o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

1	Pompa dwuroolkowa artroskopowa-1szt
2	Pompa dwuroolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem
3	Menu pompy w języku polskim
4	Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym)
5	Dreny w postaci szybko montowanych kaset
6	Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu
7	Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów
8	Możliwość podłączenia kaset dziennych
9	Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia 160 stopni, przekątna 6,5 cala, rozdzielczość 640 x 480, skala kolorów 16-bitowy
10	Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego
11	Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników
12	Min. 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy
13	Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszczka)
14	Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy
15	Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg
16	Dokładność pomiaru ciśnienie $\leq 1\%$
17	Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem
18	Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10%

19	Funkcja opróżniania stawu
20	Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V
	Zestaw kaset w torze napływu i odpływu – (opakowanie - 10 szt)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

134. Optyki artroskopowe z płaszczem i trokarem Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową 4K 30st, 4,0mm długość 140mm, szeroki kąt, HD z dedykowanym płaszczem i trokarem do optyki jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

135. Optyki artroskopowe z płaszczem i trokarem Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową 4K 30st, 4,0mm długość 165 mm, szeroki kąt, HD z dedykowanym płaszczem i trokarem do optyki jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

136. Światłowody Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Światłowód wyposażony w sensor informujący kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki od światłowodu; funkcja zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

137. Kontener do sterylizacji optyki i światłowodu Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontenera sterylizacyjnego (wanienka do sterylizacji optyki i światłowodu) z przezroczystą, perforowaną pokrywką, zamykaną plastikowymi klipsami, jako produktu równoważnego do parametrów opisanych w punktach 120?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

138. Wózek aparaturowy Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózka aparaturowego o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

	Wózek aparaturowy
1.	Wózek aparaturowy z atestem medycznym
2.	Jezdny z uchwytemi do przemieszczania i blokadą kół
3.	Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
4.	Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
5.	W komplecie/ zestawie: uchwyt do światłowodu, uchwyt na głowicę kamery, możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka, uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej, uchwyt do butli CO2, wieszak na worki z płynem do irygacji, możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka, możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności użycia dodatkowych przedłużaczy,
6.	Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm
7.	Możliwość ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach
8.	Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

139. Źródło światła Czy Zamawiający wymaga aby źródło światła było kompatybilne ze wszystkimi światłowodami dostępnymi na rynku różnych producentów Smith & Nephew (Dyonics)/Stryker/Olympus®/ACMI®/ Storz®?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

140. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

141. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazaną w ofercie Wykonawcy do przetargu, o którym stanowi §2 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

142. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 2 ust. 3 W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia z zastrzeżeniem §10 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów. Kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych

Andrzej Dowgiert

Zatwierdził:

Dyrektor SPZOZ w Sokółce

Jerzy Kułakowski